
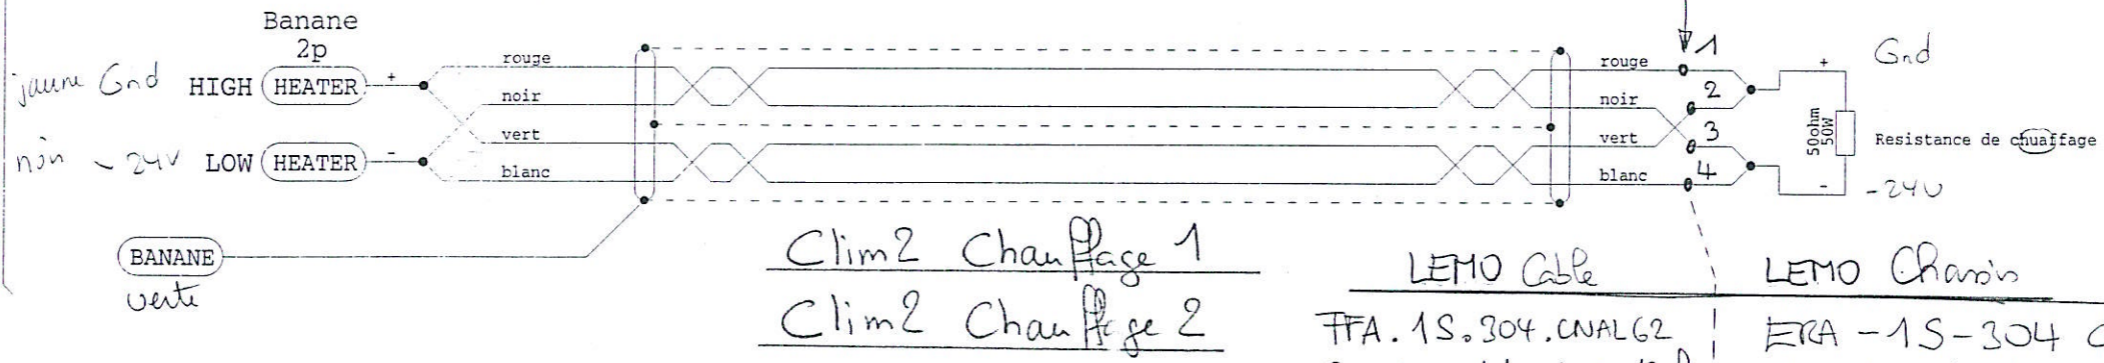
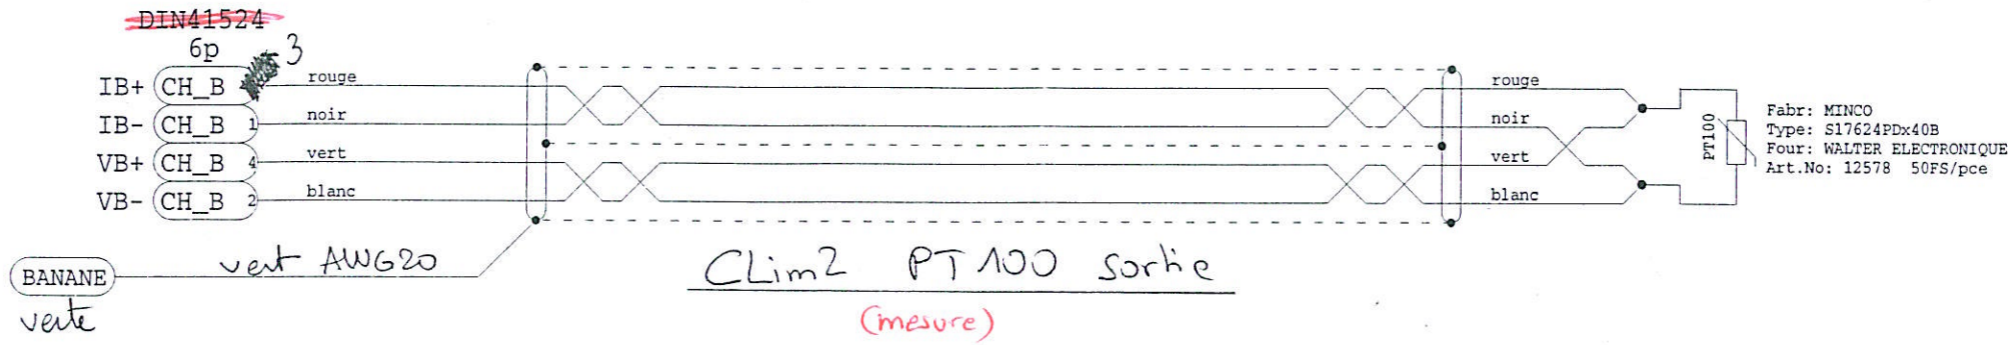


Soudure
Amphenol
C91B
fiche mâle pour câble
Distelec M10326

Contrôleur de température
LAKESHORE

Attention: le câblage
≠ DIN 41524
des sondes PT100
pour appareils Philips!

Fiche Câble mâle
DISTELC M10326

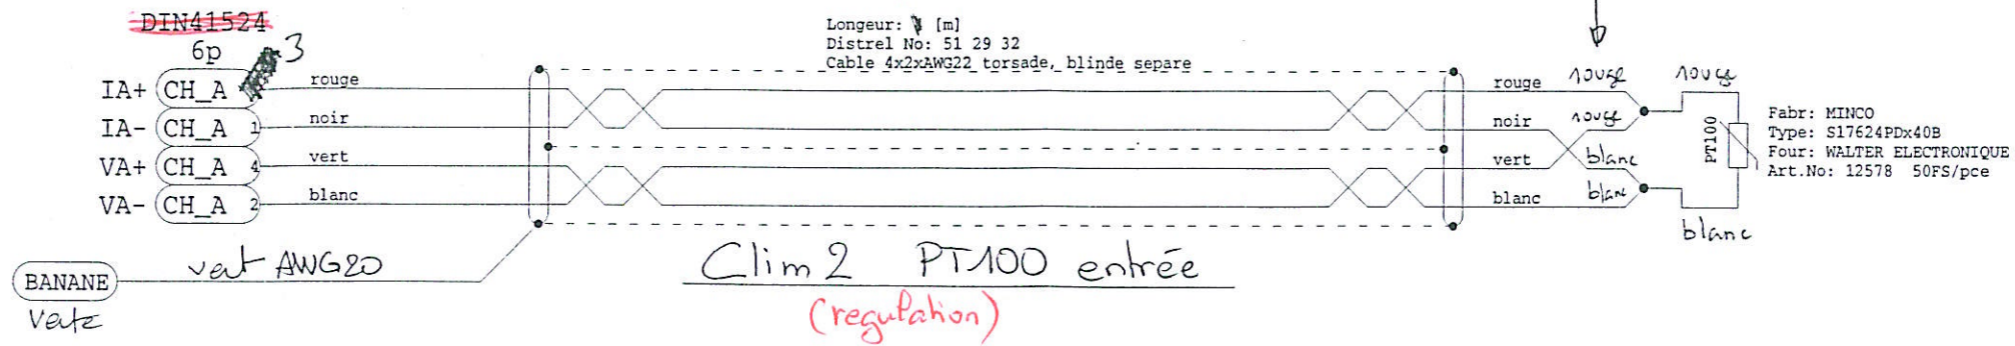

Lakeshore (détail câblage)

- ⑤ I+ diode 0GEF30k
- ⑥ TERRE
- ③ I+ Sonde PT100

R	Observations : cblTEXTcryostat.sch	Appareil No:	A3	
C	Modifications:	Sheet No:		
L	CABLAGE REGULATEUR TEMP.	Ech.	Dessine	O.Genevay
D	EXTERNE CRYOSTAT		Date	31.08.1998
Q	CORALIE CCD CLIM2	Page	Etude	Ch.Maire
.		./.	Revise	.
.	OBSERVATOIRE DE GENEVE	CORALIE-CCD		
.	Tel.(022) 755 26 11 / Fax.(022) 755 39 83			